



कर्णाली प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय

फोन नं.: ०८१-४१०१५७/१८५८०४५१२७
इमेल: hsodailekh@gmail.com
dho_dailekh@yahoo.com

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय

दैलेख, नेपाल



सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७८।०३।१८ गते

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (संशोधित) को दफा ६६ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (संशोधित) को नियम १४५ को विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने व्यवस्था सम्बन्धि प्रावधान भए बमोजिम तत्काल दैलेख जिल्ला अस्पताललाई आवश्यक पर्ने देहाय बमोजिमको Oxygen Plant with Cylinder filling system १ (एक) सेट खरिद तथा जडान कार्यका लागि सिलबन्दी बोलपत्रका माध्यमबाट खरिद गर्नु पर्ने भएकोले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ४ (चार) औं दिनको कार्यालय समय भित्र सूचनामा उल्लेखित सेवा सर्तको अधिनमा रहि यस कार्यालयबाट स्वीकृत बिस्तृत प्राविधिक स्पेसिफिकेशन बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक फर्म/कम्पनीहरूले स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, दैलेखबाट पछि फिर्ता नहुने गरी रु. ३०००- तिरी बोलपत्र फाराम खरिद गरी रु. १०८- को टिकट टाँसी निम्न शर्तको अधिनमा रहि रित पूर्वकको शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपशिल:

१. बोलपत्र फाराम खरिद गर्दा अध्यावधिक नविकरण भएको फर्मको इजाजत प्राप्त पत्र, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा म.अ.कर दर्ता भएको प्रमाण पत्र, आ.व. ०७६।०७७ को कर चुक्ता प्रमाण पत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रहरू (मान्यता प्राप्त नोटरी पब्लिकद्वारा) प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न हुनुपर्नेछ । बोलपत्र दाता खरिद कारबाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, यो खरिद कारबाहीमा आफ्नो स्वार्थ नबाझिएको र व्यवसायी सम्बन्धी कसुर सजाय नपाएको भनि लिखित रूपमा गरेको घोषणा पत्र समेत सिलबन्दी बोलपत्र साथ पेश गर्नु पर्ने छ । तर कालोसूचीमा परेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निज आफैँ वा निज समेतको नाममा भैरहेको अर्को फर्म, संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्न पाइने छैन ।
२. खरिद भएको बोलपत्रहरू, स्वीकृत स्पेसिफिकेशन रित पूर्वक भरि क्याटलग वा बोस र एवं आवश्यक कागजातहरू समेत संलग्न राखि आफ्नो स्वस्थ र उचित मुल्यको आर्थिक प्रस्ताव, सामान आपूर्ति गरि जडान गर्न लाग्ने समय समेत खुलाई मूल्य सृष्टिको आवश्यक कागजातहरूमा सहिछाप गरि सिलबन्दी गरि खासको बाहिर व्यक्ति वा फर्मको पुरा नाम, ठेगाना, कामको विवरण स्पष्ट लेखि ५ (पाँचौं) दिनको १२:०० बजे भित्र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, दैलेखमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । अन्यथा मान्यता दिइने छैन । दर्ता भएका सम्पूर्ण शिलबन्दी बोलपत्र ठेकेदार वा निजको आधिकारीक प्रतिनिधिहरूको र कार्यालयको प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा सोहि दिनको २:०० बजे खोल्ने छ । बोलपत्र दाता वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिहरू अनुपस्थित रहेमा पनि बोलपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन ।
३. बोलपत्र साथ धरीटी वापत तपशिलमा उल्लेखित रकम प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, दैलेखको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक शाखा दैलेखमा रहेको धरीटी खाता नं.४०१०१००२०२०३०००० मा जम्मा गरेको भौचर वा सो रकम बराबरको मान्यता प्राप्त बैंकबाट यस कार्यालयको नाममा जारी गरेको कम्तीमा ९० (नब्बे) दिन म्याद भएको बिड बण्ड संलग्न हुनुपर्नेछ । नगद लाई मान्यता दिइने छैन । ठेक्का अवधी भर कुनै पनि मुल्य बृद्धि दिइने छैन ।
४. शिलबन्दी बोलपत्र खरिद गर्ने, दर्ता गर्न र खोल्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेमा त्यसको लगत्तै कार्यालय खुलेको दिन सोही समयमा उक्त कार्य हुनेछ ।

श्री. स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय

५. शिलबन्दी बोलपत्रमा अंक र अक्षर दुबैमा प्रष्ट सँग लेखिएको हुनुपर्नेछ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिइनेछ । केरमेट भएको ठाउँमा अनिवार्य सहिछाप भएको हुनुपर्नेछ ।
६. नियमानुसार लाग्ने कुनै पनि कर, दस्तुरहरू ठेकेदार स्वयंमले ब्यहोनु पर्नेछ ।
७. म्याद नाघी वा रित नपुगी वा कुनै शर्त राखि पेश हुन आएको शिलबन्दी बोलपत्र उपर कुनै पनि कारबाही गरिने छैन ।
८. बोलपत्र सम्बन्धी सूचनामा कुनै संशोधन भएमा कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिनेछ ।
९. प्राप्त बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहित रहनेछ ।
१०. शिलबन्दी बोलपत्र दाताले लागत अनुमान भन्दा १५ प्रतिशत सम्म कम अंक कबुल गरेमा कबुल अंकको ५ प्रतिशत र लागत अनुमानको १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटेमा कबुल गरेको अवस्थामा १५ प्रतिशत भन्दा जति रकमको घटी कबुल गरेको छ सो को ५० प्रतिशत हुन आउने रकम कबुल अंकको ५ प्रतिशत थप गरी कार्य सम्पादन जमानत राख्नु पर्नेछ ।
११. यस सूचनामा लेखिएको हकमा यतै सूचना बमोजिम र यसमा उल्लेख नभएको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (संशोधित) र नेपाल सरकारको प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
१२. शिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धी अन्य कुरा बुझ्नु परेमा कार्यालय समय भित्र यस कार्यालयको फोन नम्बर ०८९-४१०१५७/९८५८०४५१२७ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

तपसिलः

क्र. सं.	ठेक्का नं.	विवरण	बिडबण्ड रकम (रु.)	बोलपत्र खरिद दस्तुर (रु.)	दर्ता गर्ने अन्तिम मिति र समय	खोल्ने मिति र समय	कैफियत
१.	६०७७०७८	Oxygen Plant with Cylinder filling system १ (एक) सेट खरिद तथा जडान कार्य ।	१८७५००- (अक्षेप्सी एक लाख सतासी हजार मात्र)	३०००-	२०७८।०३।२२ गते दिनको १२:०० बजे सम्म ।	२०७८।०३।२२ गते दिउँसो २:०० बजे ।	सश्लित विवरणमा उल्लेख नभएको कुराहरू स्वीकृत प्राविधिक स्पेसिफिकेशन बमोजिम हुनेछ र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, दैलेख सम्म दुबानी तथा जडान कार्य बोलपत्रकर्ता स्वयंमले गर्नु पर्नेछ ।



निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, दैलेख ।


डि. स्वास्थ्य सेवा अन्वेषणक

Technical Specifications of Oxygen Plant with cylinder filling system

S.N	Purchaser Technical Specifications	Compliance (YES/NO)	Page No. in Catalogue/ Manual	Remark
	Oxygen Plant with Cylinder filling system			
	Manufacturer:			
	Brand:			
	Type/Model:			
	Country of Origin:			
1	Description of function			
1.1	The Oxygen Plant generates the oxygen at low pressure and the booster gas filling receives a gas at low pressure and increases the pressure of a gas to the required output for filling purpose.			
2	System Configuration			
2.1	Should have complete system comprising of Compressor, Storage tank, Dryer, Filter, Oxygen generator, oxygen tank, Booster, supercharging system and filling row.			
3	Technical Specifications			
3.1	Compressor <ul style="list-style-type: none"> • Power rating of 18kw or better • Rated exhaust capacity of 3m³/min or more • Discharge pressure of 7 bar or more 			
3.2	Primary Air Storage Tank <ul style="list-style-type: none"> • Volume capacity of 1m³ at least. • Should have safety valve, bleed down valve, pressure gauge, pressure vessel certificate at least • Should have designed pressure of 5% or more than working pressure. 			
3.3	Dryer <ul style="list-style-type: none"> • Rated power of 1.2KW or better • Rated capacity of 3.5m³ or better • Very low dew point 2- 10°C 			
3.4	Filter <ul style="list-style-type: none"> • At least 4 filter equipped • Residual oil content should be ≤0.003 ppm after filtration • Filtration accuracy should be ≤ 0.01µm • Treatment capacity should be 10m³/min or better 			
3.5	Secondary storage tank <ul style="list-style-type: none"> • Volume capacity of 1m³ at least. 			



Er. Shaurob Sijapati
NEC-Biomedical 'A'368

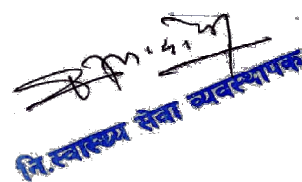



स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक

	<ul style="list-style-type: none"> Should have safety valve, bleed down valve, pressure gauge, pressure vessel certificate at least Should have designed pressure of 5% or more than working pressure 			
3.6	Oxygen Generator <ul style="list-style-type: none"> Should be PSA or VPSA principle based. Should have capacity to produce oxygen at rate of 10Nm³/hr Oxygen purity should be 93% or more Dew point should be -45°C or better. Output pressure should be 3 bar or more 			
3.7	Oxygen Tank <ul style="list-style-type: none"> Volume capacity of 1m³ at least. Should have safety valve, bleed down valve, pressure gauge, pressure vessel certificate at least Should have designed pressure of 5% or more than working pressure 			
3.8	Oxygen Booster/Filling system <ul style="list-style-type: none"> Should be compatible for filling of all capacity of cylinders Should have flow rate of 10m³ or more Should have intake pressure of 3 bar or more. Should have output pressure of 150 bar. Should be equipped with powerful motor of 7.5KW or more Should be capable of filling 45 or more numbers of Cylinder of 40L per day Should have water cooling facility to reduce the heat Should have intake air temp of ≤35°C Should have facility to fill 10 cylinders at a time. 			
3.9	Oxygen supercharging System <ul style="list-style-type: none"> Should have 4 inflatable heads in manifold. 			
3.10	The bidders should clearly mention and submit the schedule for lubricating parts, cleaning, changing the filter, Changing molecular sieve and others maintenance related work on separate sheet.			
4	Accessories, Consumables and Spare Parts			
4.1	All the standard accessories, consumables and spare parts supplied by the company should be listed in the separate sheet.			



Er. Shaurab Sijapati
NEC: Biomedical 'A' 368

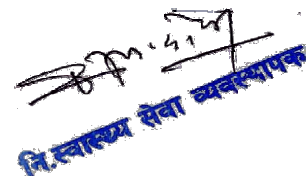4.2	Should supply additional filter set.			
4.3	Should ensure the availability of spare parts and accessories for at least five years and provide after sale service during that period.			
5	Operational Environment and Power Supply			
5.1	The system offered shall be designed to operate normally under the conditions of the purchaser's country. The conditions include Power Supply, Climate, Temperature, Humidity, etc.			
5.2	Power supply: 3 phase, 400V 50/60Hz with 3m long power cable.			
6	Standards, Medical Device Regulation and Safety Requirements			
6.1	Must submit ISO 13485 or ISO 9001 for medical devices.			
6.2	Must submit European CE as directed by Council Directive 93/42/EEC (Medical Device Directive) or USFDA approved product certificate.			
7	User Training			
7.1	Must provide onsite operation, basic maintenance and service training to user.			
8	Warranty			
8.1	The bidders must provide warranty for 2 years or more.			
8.2	During warranty period supplier must ensure corrective, breakdown maintenance whenever required.			
9	Installation and Commissioning			
9.1	The supplier must accomplish proper installation and commissioning of equipment with qualified and certified personnel.			
10	Documentation			
10.1	User(Operating) manual in English			
10.2	Service(Technical/Maintenance) manual in English			
10.3	Valid authorization letter from the manufacturer			
10.4	Certificate of calibration and inspection from factory			
Bidder must completely fill the Technical Specification Form (TSF). Only Yes/no/all complies should not be written. Page number in the catalogue of all the required parameters must be clearly mentioned and highlighted. Failure in doing so may lead to rejection of bid from technical committee.				



[Handwritten Signature]
नि.स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक

[Handwritten Signature]

Er. Shaumb Sijapati
NEC: Biomedical 'A' 068